

Behandlare: Sample Report

Patient:

Kön:

Typ av prov: Serumsprov

IgE

Referencenummer US:

Ålder:

Födelsedatum:

Datum för provtagning:


Mottagit:

Färdig:

CLIA #: 50D0965661

CAP accredited

Møgelsvampar

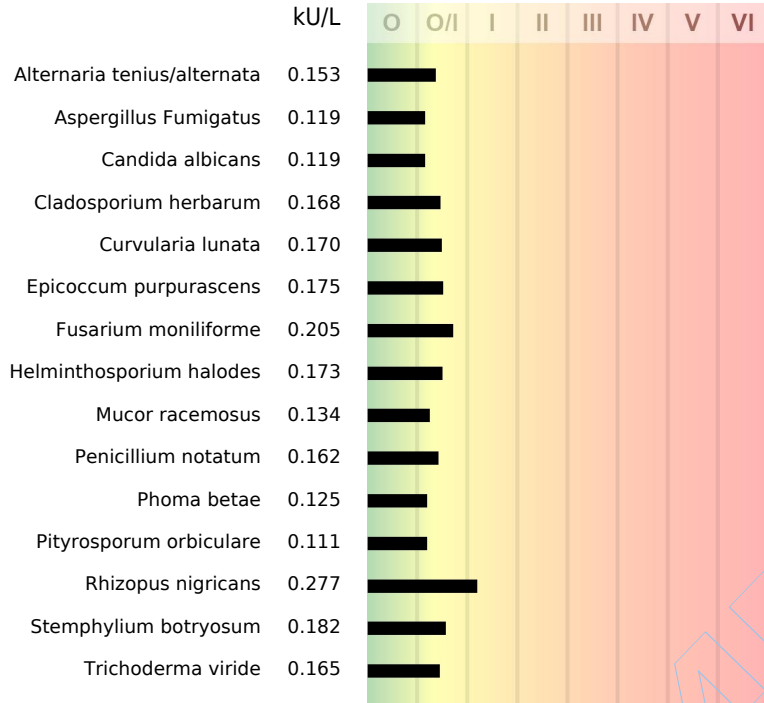

Totalt IgE*: 19.2 IU/mL

Referensområde:

≥10 år: ≤87.0 IU/mL

<10 år: Not available

SAMPLE REPORT

0	O/I	I	II	III	IV	V	VI
<0.10 Frånvarande eller ej mätbar	0.10-0.24 Valdigt låg	0.25-0.39 Låg	0.40-1.29 Moderat	1.30-3.89 Hög	3.90-14.99 Valdigt hög	15-24.99 Valdigt hög	≥25 Valdigt hög

*The Total IgE is performed using Immulite System, and the reference range is updated accordingly. IgE Chemiluminescence-analysen som används av US BioTek Laboratories er godkjänd av av U.S. Food and Drug Administration. Karakteristiken för utföringsformen för IgE-analysen har verifierats av US BioTek Laboratories, LLC, 16020 Linden Ave N, Shoreline, WA 98133, USA. IgE-testresultat ska användas av vårdgivare, i samband med annan relevant klinisk information, för att diagnostisera IgE-medierade allergiska störningar. Högre totala IgE-nivåer kan föreslå förhöjd klinisk reaktivitet mot specifika livsmedel men bör tolkas i samband med annan relevant information.